

Reservrutin för beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka

Bakgrund

Det ska finnas ett system för dokumentation av beredning som gör det möjligt att följa varje preparat såväl i fråga om använda råvaror som i fråga om metoder, kontroll, förvaring och distribution (LVFS 2014:4, kap 4, 3§).

Beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka dokumenteras vanligtvis i IBC-NM. Om systemet eller någon del av systemet inte fungerar behöver en reservrutin finnas som beskriver hur dokumentation ska utföras så kraven på spårbarhet uppfylls.

Förändring sedan föregående version

Lagt blanketter som bilaga.

Skrivit in placering av pärmar.

Rutin

- Syftet med rutinen är att klargöra ansvaret för att få spårbarhet vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka när IBC-NM inte fungerar.
- IBC-NM ska alltid användas då det är möjligt, denna reservrutin ska bara användas i nödfall.
- För att upprätthålla kompetensen ska reservrutinen testas av all beredande personal en gång om året.
- Problem med IBC-NM anmäls genom att ringa IT-support (010-473 71 00). Säg gärna att systemet är en viktig del av patientflödet och behöver fungera igen så snart som möjligt.

- När reservrutin används ska en avvikelse skrivas i MedControl.
- Meddela sektionsledare, sakkunnig farmaceut samt sjukhusfysiker när reservrutin används.

Beredning

Aktivitetmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.
- Eventuell Mo-99-kontroll utförs i IBC-Lite enligt bilaga 2.
- Blanketter, beredningskort och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. I Uddevalla i genomräkningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.
- Beredningen utförs enligt beredningskort för respektive kit.
- Fyll i blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka (bilaga 3).
- Fyll i etikett med uppgift om aktivitet, aktivitetskoncentration, datum, tid, versionsnummer och signatur. Placera etiketten på blyskyddet.
- När/om systemet fungerar igen kan beredda preparat/eluater bokas in som lager i IBC-NM (se [IBC-NM](#) avsnitt Boka lager). Fyll manuellt i aktivitet istället för att mäta. Använd tidpunkt, aktivitet och volym från beredningen (det som står på eluering/berednings-blanketten). Skriv i fältet *Anmärkning* att reservrutin använts vid beredning/eluering.

OBS! Boka ej in som kit utan som aktivt preparat med ^{99m}Tc .

- Korrigera lagret i IBC-NM (se [IBC-NM](#)). Till exempel ta bort NaCl, elueringsflaskor och kit som har använts vid beredningen.
- Ifylld blankett sätts in i pärm:
 - NÄL: i skåpet i dispenseringsrummet
 - Uddevalla: i injektionsrummet

Dispensering

Aktivitetmätning utförs i IBC-Lite (se bilaga 1).

- Utför manuell kontroll av aktivitetsmätare i IBC-Lite enligt bilaga 1.
- Blanketter, beredningskort, doseringstabeller och etiketter finns på intranätet samt samlat i pärm. I Uddevalla i genomräkningsskåp, på NÄL en i beredningsrum och en i dispenseringsrum.
- Kontrollera vilken dos patienten ska få i aktuellt beredningskort eller doseringstabell
- Dra upp sprutan. Kompensera för tid och det som fastnar i sprutan (50% för NanoHSA, 10% för övriga)
- Fyll i blanketten: Dispensering av radiofarmaka (bilaga 4).
- Märk uppdragen spruta med etikett med uppgift om personnummer, namn, radiofarmaka, aktivitet och klockslag vid dispensering, datum, sprutnummer och

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

signatur. Personnummer och namn behöver inte noteras om administrering sker i direkt anslutning till dispenseringen.

- Eftermätning utförs manuellt i IBC-Lite och dras bort från den dragna dosen. Korrigering för tid behöver ej göras.
- Vid dokumentation i IDS7 skriv en kommentar om att reservrutin använts.
- Ifylld blankett sätts in i pärm:
 - NÄL: i skåpet i dispenseringen
 - Uddevalla: i injektionsrummet

Generatorhiss ur funktion

Om generatorhissen är ur funktion kan den öppnas som vid generatorbyte och generatorm elueras. Om mer än en dag, kontakta sjukhusfysiker för att diskutera strålskyddsaspekt.

Ansvar

- Tjänstgörande biomedicinsk analytiker ansvarar för dokumentationen.
- Sektionsledare ansvarar för att aktuella etiketter och dokument finns i pärnarna. Sök efter "Etikett" i SOFIA Sharepoint Kliniskfysiologi/NuklearAdministrering.


BILAGA 1


Reservrutin Användning av aktivitetmätare i IBC Lite

Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)



- Varningen "It's not possible to connect to the local database" visas.
- Klicka OK
- Innan dagens första användning: utför konstansk kontroll med ^{137}Cs -källan.
- Välj nuklid Cs-137 i IBC Lite enligt bilden nedan.

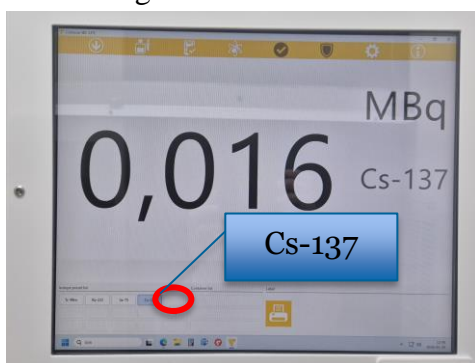

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Cs-137 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.
- Placera ^{137}Cs -flaskan i dippern och sänk ned i aktivitetmätaren.
- Läs av värdet och kontrollera att det är inom godkänt intervall i tabellen på nästa sida. Läs av för aktuellt kvartal och år. Godkänd aktivitet är $\pm 5\%$ från aktiviteten, se "Godkänt intervall" i tabellen.
- Ta bort ^{137}Cs -flaskan från aktivitetmätaren.
- Om godkänt, fyll i OK i Blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka (beredningsrum) alternativt Dispensering av radiofarmaka (Dispenseringsrum).
- **Välj åter Tc-99m i snabblistan.** Skriv upp bakgrundsvärdet i respektive blankett. Nu kan aktivitetmätaren användas.
- Om underkänd, Kontrollera att inga andra strålkällor finns i närheten som kan störa mätningen, Starta om IBC-Lite, och prova igen. Om fortfarande underkänd, Använd inte aktivitetmätaren. Kontakta sjukhusfysiker/MT.

Sönderfallstabell ¹³⁷Cs

Käll-nr: NÄL: 2609-81-13 Uddevalla: 2609-81-17

Referensaktivitet: 7,55 MBq

Referensdatum: 2026-07-01

Kvartal och år	Aktivitet (MBq)	Godkänt intervall (MBq)
Q2 april-juni 2026	7,59	7,21 - 7,97
Q3 juli-september 2026	7,55	7,17 - 7,93
Q4 oktober-december 2026	7,51	7,13 - 7,88
Q1 januari-mars 2027	7,46	7,09 - 7,84
Q2 april-juni 2027	7,42	7,05 - 7,79
Q3 juli-september 2027	7,38	7,01 - 7,75
Q4 oktober-december 2027	7,34	6,97 - 7,70
Q1 januari-mars 2028	7,29	6,93 - 7,66
Q2 april-juni 2028	7,25	6,89 - 7,61
Q3 juli-september 2028	7,21	6,85 - 7,57
Q4 oktober-december 2028	7,17	6,81 - 7,53
Q1 januari-mars 2029	7,13	6,77 - 7,48
Q2 april-juni 2029	7,09	6,73 - 7,44
Q3 juli-september 2029	7,04	6,69 - 7,40
Q4 oktober-december 2029	7,00	6,65 - 7,35
Q1 januari-mars 2030	6,96	6,62 - 7,31
Q2 april-juni 2030	6,92	6,58 - 7,27
Q3 juli-september 2030	6,88	6,54 - 7,23
Q4 oktober-december 2030	6,84	6,50 - 7,19
Q1 januari-mars 2031	6,80	6,46 - 7,14
Q2 april-juni 2031	6,77	6,43 - 7,10
Q3 juli-september 2031	6,73	6,39 - 7,06
Q4 oktober-december 2031	6,69	6,35 - 7,02
Q1 januari-mars 2032	6,65	6,32 - 6,98
Q2 april-juni 2032	6,61	6,28 - 6,94
Q3 juli-september 2032	6,57	6,24 - 6,90
Q4 oktober-december 2032	6,53	6,21 - 6,86
Q1 januari-mars 2033	6,50	6,17 - 6,82
Q2 april-juni 2033	6,46	6,14 - 6,78
Q3 juli-september 2033	6,42	6,10 - 6,74
Q4 oktober-december 2033	6,39	6,07 - 6,70
Q1 januari-mars 2034	6,35	6,03 - 6,67
Q2 april-juni 2034	6,31	6,00 - 6,63
Q3 juli-september 2034	6,28	5,96 - 6,59
Q4 oktober-december 2034	6,24	5,93 - 6,55
Q1 januari-mars 2035	6,20	5,89 - 6,51
Q2 april-juni 2035	6,17	5,86 - 6,48
Q3 juli-september 2035	6,13	5,83 - 6,44
Q4 oktober-december 2035	6,10	5,79 - 6,40
Q1 januari-mars 2036	6,06	5,76 - 6,37

BILAGA 2

Reservrutin 99Mo-test i IBC-Lite

^{99m}Tc mäts i med vanlig dipper, ^{99}Mo mäts i med metallhållaren och blyskydd.

- Stäng IBC-NM och öppna IBC-Lite (sök med windows sökverktyg eller klicka på genvägen på skrivbordet)
- Varningen "It's not possible to connect to the local database" visas.
- Klicka OK
- Kontrollera på aktuell blankett att kontroll av aktivitetsmätare är utförd i IBC-Lite. Om inte: utför denna enligt beskrivning i bilaga 1.





Mät ^{99m}Tc -aktiviteten:

- Kontrollera att Tc-99m-fönster är valt. Om inte: välj detta i snabblistan.
- Placera eluatet i dippern och sänk ned i aktivitetsmätaren.
- Läs av ^{99m}Tc aktiviteten (Tc) i GBq

Mät ^{99}Mo -aktiviteten:

- Välj nuklid Mo-99 i IBC Lite enligt bilden nedan.

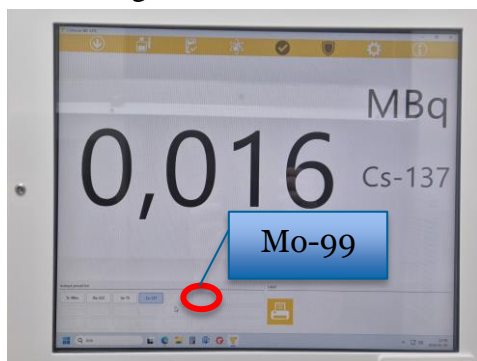

- Om den inte finns i snabblistan, klicka på  och välj Mo-99 här. Bläddra med pilarna om nukliden inte visas.
- Sätt eluatet i blyskyddet och placera det i aktivitetsmätaren
- Läs av ^{99}Mo aktiviteten (Mo) i MBq
- Ta bort eluatet
- Sänk ner metallhållare och blyskydd i aktivitetsmätaren och mät bakgrunden ($Mo_{bakgrund}$) i MBq
- Dra bort bakgrunden ($Mo_{bakgrund}$) från ^{99}Mo aktiviteten (Mo)
- Dela den bakgrundskorrigerade ^{99}Mo aktiviteten med ^{99m}Tc aktiviteten ($\frac{Mo - Mo_{bakgrund}}{Tc}$) och fyll i resultatet i Blanketten: Eluering och beredning av radiofarmaka. Resultatet ska vara mindre än 0,04 för att testet ska vara godkänt.
- **Välj åter Tc-99m i snabblistan**

BILAGA 3**Blankett – Eluering och beredning av radiofarmaka**

Generator

Elueringsvätska (100 ml, 0,9 % NaCl)

ParcelID:

Utgångsdatum:

Batchnr:

Referensaktivitet [GBq]:

Eluering efter uppackning					Elueringsflaskans lot nr:	
Datum (år-mån-dag)	Klock- slag	Volym [ml]	Total akt. [GBq]	Akt.konc. [MBq/ml]	Mo PASSED (IBC-NM < 0,004% IBC-Lite < 0,04)	Sign

Kontroll av aktivitetsmätare (IBC-Lite): OK

Bakgrund [MBq]:.....

Eluering nr					Elueringsflaskans lot nr:	
Datum (år-mån-dag)	Klock- slag	Volym [ml]	Total akt. [GBq]	Akt.konc [MBq/ml]	Anteckningar	Sign

Beredningar med ^{99m}Tc

Kit		Eluat	NaCl	Färdigt kit				Sign
Namn/ versionsnr	Batchnr.	Akt.konc. [MBq/ml]	Batchnr.	Vol. [ml]	Mätt akt. [MBq]	Akt.konc. [MBq/ml]	Klock- slag	

Kommentar (t.ex. beskriv varför reservrutin har använts):

BILAGA 4

Blankett – **Dispensering av radiofarmaka**

Datum:..... Kontroll av aktivitetsmätare (IBC-Lite): OK Bakgrund [MBq]:

Radiofarmaka	Versions- nummer	Vid spädning med NaCl Batchnr	Aktivitet i sprutan vid dispensering		Aktivitet i sprutan vid eftermätning		Spruta ¹ /Sign (Nr/sign)	Anteckningar T.ex. aktivitetskonc. i flaskan vid dispensering (MBq/ml, uppdragen volym, tid), patientvikt
			[MBq]	Klockslag	[MBq]	Klockslag		

Sprutorna numreras löpande för respektive beredning. Då flera versionsnummer finns av en beredning fortsätter ändå nummerserien.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus, Klinisk fysiologi
NÄL

Innehållsansvar: Bianca Bugge, (biabu1), Sektionsledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10088-77811585-85

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-10

Giltig till: 2028-06-10