Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL
Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare
Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Giltig från: 2026-10-26
Giltig till: 2028-10-26

CBCT Fotled, provokation eller belastning (C71142)

Syfte

Metodbeskrivning för CBCT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Tillägg: Belastad fotled i gips utförs ej i CBCT.

Inför undersökningen

Indikationer	Frakturkontroller, degenerativa förändringar, kartläggning av fraktur mm.
Förberedelser	Inga.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.10 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Stående. • Endast på begäran av remittent. • Aktuell fot i stående på pall i gantryt. • Den aktuella fotleden så nära isocenter som möjligt. • Motsatt sidas ben böjs undan. • OBS! FOV är 10 x 16 cm (large) eller 6 x 16 cm (small). Intresseområdet ska inkluderas med bra marginal. • OBS! Belastad fotled i gips utförs **EJ** i CBCT.

Bildtagning


Scout → Serie 1

Bild/serie	Inställning
Scout	Ovanför fotleden – nedanför fotleden. Centrering i mitten av fotleden.
1. Fotled K-	↓ Hela fotleden.



Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Vinkelrätt mot tibias längsaxel.
COR	Parallellt med tibias längsaxel, framifrån – bak.
SAG	Parallellt med tibias längsaxel, inifrån – ut.

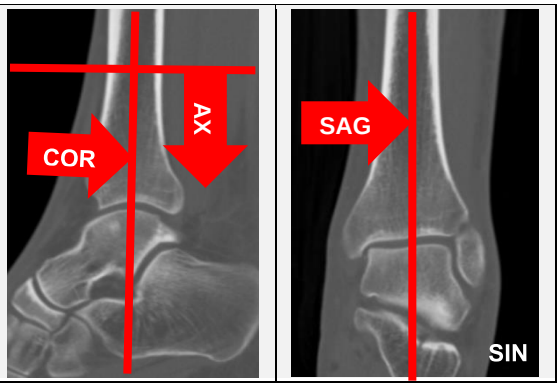


Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Verity)	Fönster	Arkiv
1. Fotled K-	AX	0,4/0,4		C500 W3000	PACS
	COR	0,4/0,4		C500 W3000	PACS
	SAG	0,4/0,4		C500 W3000	PACS
	AX	0,4/0,4		C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1

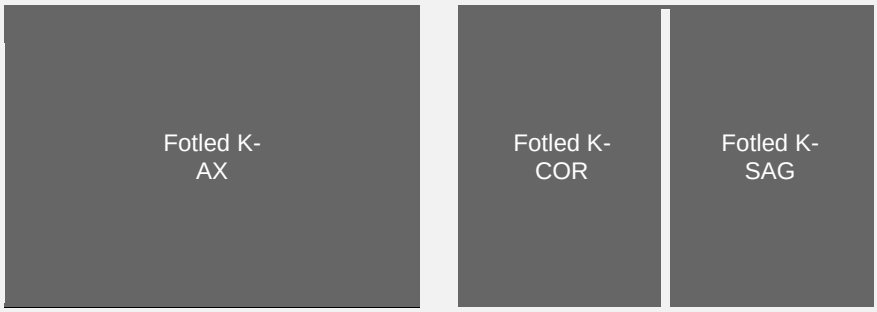

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1524700195-119

Version: 3.0

Giltig från: 2026-10-26

Giltig till: 2028-10-26