Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare
Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare
Giltig från: 2026-11-02
Giltig till: 2027-11-30

DT Halsrygg (820000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


Inför undersökningen

Indikationer	Skelettskada, felställning, destruktioner mm.
Förberedelser	Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning


Scout → Serie 1


Bild/serie	Inställning
Scout	Ovanför ytterörat – Th1.
1. Halsrygg K-	↓ Hörselgången – Th1. *Patienten ska andas lugnt och inte svälja.*

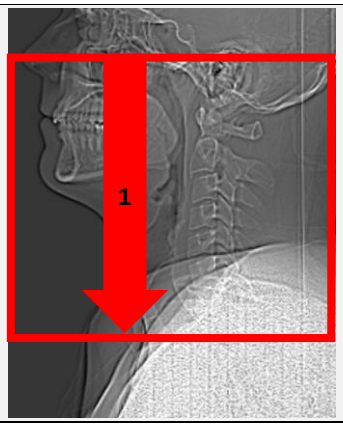

Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Parallellt med disken C4-C5. DFOV ska omfatta hela kotorna och kotutskotten samt mjukdelarna prevertebralt (ca 150 mm).
COR	Parallellt med kotpelarens längsaxel, vinkelrätt mot AX
SAG	Parallellt med kotpelarens längsaxel.
VRID DX och SIN	Vinklas cirka 45° åt höger och vänster så att foramina intervertebralia framträder tydligt.



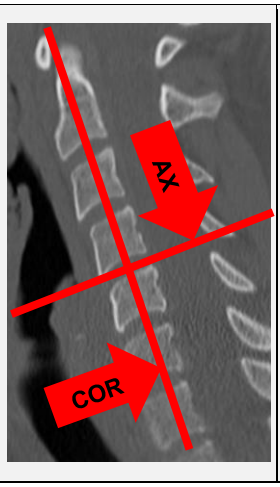



Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Halsrygg K-					
	COR	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	VRID DX	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	VRID SIN	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS/ Syngo.via
	AX	0,6/0,6	Br60/Standard/FC08	C500 W3000	PACS/ Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-205

Version: 11.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2027-11-30