OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Giltig från: 2026-11-02
Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare
Giltig till: 2027-11-30
Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Hjärna K- med neurokranium (810000B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikationer	Blödning, infarkt etc med skalltrauma.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Rygläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i högsta läget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

Scout → Serie 1


Bild/serie	Inställning
Scout	Hakspets – skalltak.
1. Hjärna K-	↑ Bakre skallgrop – skalltak.




VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Reformatering

Projektion	Inställning
AX hjärna K-	Parallellt med HYFA-planet (från hypofysens nederkant till fjärde ventrikelns bakre spets). DFOV 240 mm som standard.
AX neuro-kranium	Vinklas så att ”patienten tittar rakt fram”.
COR hjärna K-	Parallellt med pons bakre begränsning.
SAG hjärna K-	Parallellt med falx.

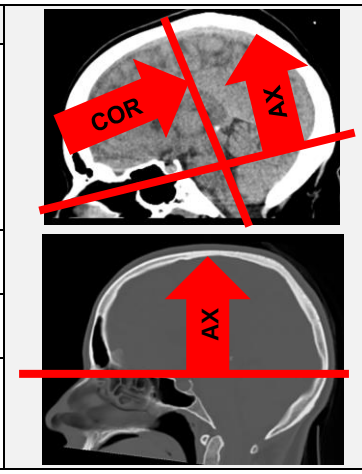

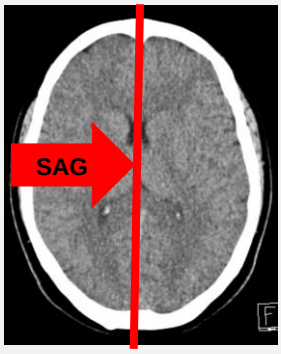

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Hjärna K-	AX	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	COR	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	SAG	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	AX	0,6/0,6	H32/Soft/FC26	C35 W80	Syngo.via
↳ neurokranium	AX	1/1	H60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-212

Version: 8.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2027-11-30