

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-03-25

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

DT Sternum K+ (836800)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikationer	Retrosternal abscess mm.
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none"> • Kreatinin och GFR. • PVK
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Buk venös".
Strålskydd	<p>Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet.</p> <p>För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</p>
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet.

Bildtagning

Bild/serie	Inställning	
Scout	Jugulum – diafragma.	
1. Sternum K+	↓ Jugulum – processus xiphoideus. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>	


Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Vinkelrätt mot sternums längsaxel. DFOV skall omfatta hela sternum med omgivande mjukdelar (ca 200 mm).		
COR	Parallellt med sternums längsaxel.		
SAG	Parallellt med medellinjen.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Sternum K+	AX	5/3	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	COR	5/3	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	SAG	5/3	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C50 W450	Syngo.via PACS
↳ skelett	AX	3/3	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

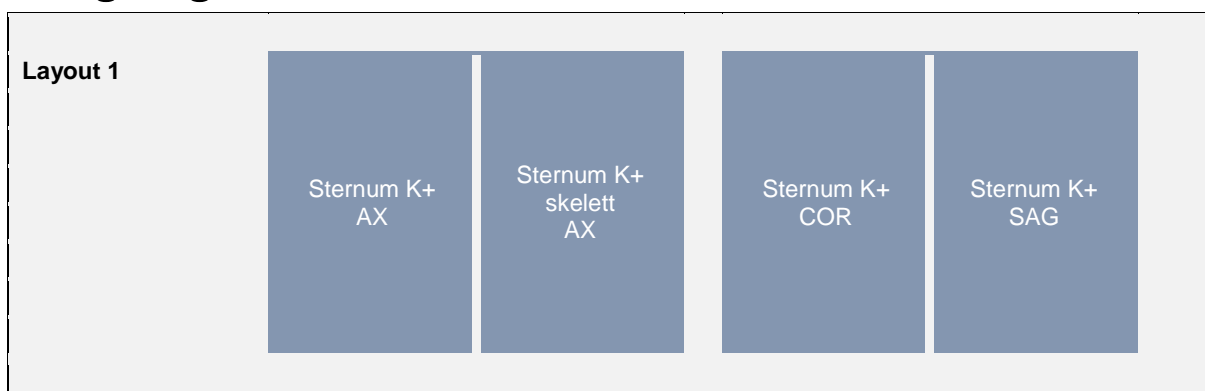

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-259

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25