Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare
Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare
Giltig från: 2026-11-02
Giltig till: 2027-11-30

DT Temporalben (816000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikationer	Kolesteatom, destruktioner, anatomiska anomalier. Vid utredning av komplicerad otit/mastoidit/abscess väljes istället DT ansikte mjukdelar K+.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning


Scout → Serie 1


Bild/serie	Inställning
Scout	Hakspets – skalltak.
1. Temporalben K-	↑ Processus mastoideus – sinus frontalis underkant.



Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Parallellt med hårda gommen. Justeras så att anatomin blir symmetrisk.
COR	Justeras så att anatomin blir symmetrisk och båda koklea ligger i linje.
SAG	Parallellt med medellinjen.

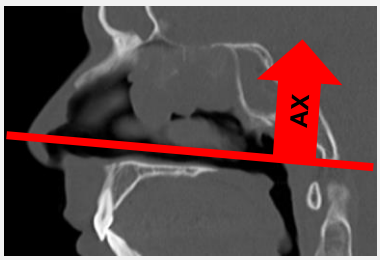

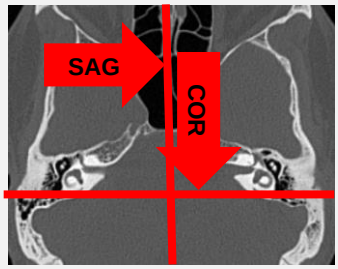


Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Temporalben K-	AX	0,6/0,6	U70/Ultra/FC81	C500 W3000	PACS
	COR	0,6/0,6	U70/Ultra/FC81	C500 W3000	PACS
	SAG	0,6/0,6	U70/Ultra/FC81	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	U70/Ultra/FC81	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1

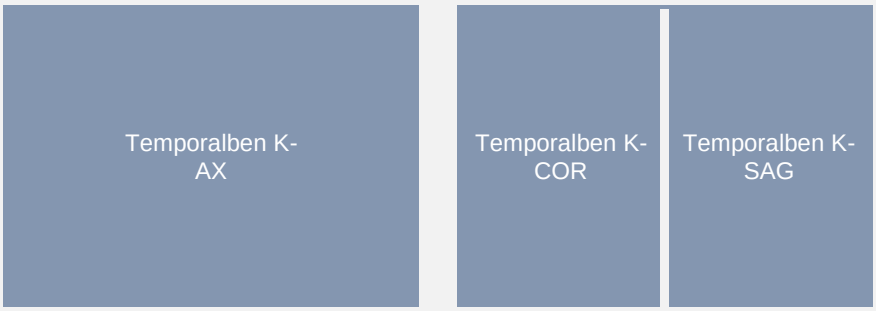

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-260

Version: 8.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2027-11-30