

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11

Reservrutin Arbetsflöde PACS-stopp

Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när PACS inte fungerar.

På avdelningen och i screeningvagnarna finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsflöde PACS-stopp

Screening i vagn

Planerat PACS-stop

- Inga kvinnor är bokade.

Akut PACS-stopp

- Börja med att identifiera om det är fel på 4G-uppkopplingen eller PACS.
- Följ flödesschema, sid 3 nedan.

Om PACS fortfarande inte fungerar efter felsökning

- Kvinnorna skickas hem.
- Kontakta mammografiavdelningen som får informera och boka om kvinnorna. Sekreterare skickar ny kallelse till alla kvinnor som inte har blivit undersökta denna dag.
- Om ni lämnar vagnen, sätt upp en skylt på dörren. Se flik nr 4 i reservrutinpärmen.

Screening på avdelningen

Planerat PACS-stopp

- Inga kvinnor bokade.

Akut PACS-stopp

- Kvinnorna skickas hem och får ny kallelse.

Klinisk mammografi/Bröstmottagning/Selektioner

Planerat PACS-stopp

- Inga bokade patienter.

Akut PACS-stopp

- Undersökningar kan inte utföras då diagnostisering på röntgenmodalitet Siemens Revelation inte är möjlig.
- Patienterna skickas hem och får ny tid.

Indikering

Akut och planerat PACS-stopp

Bedöms från fall till fall.

Preparatröntgen

Planerat PACS-stopp

I möjligaste mån planeras inga operationer vid planerade PACS-stopp.

Akut PACS-stopp


Undersökning av preparat utförs på modalitet med manuell registrering se flik nr 6 och 7.

MDK

Akut och planerat PACS-stopp

Inga bilder finns tillgängliga.

Flödesschema

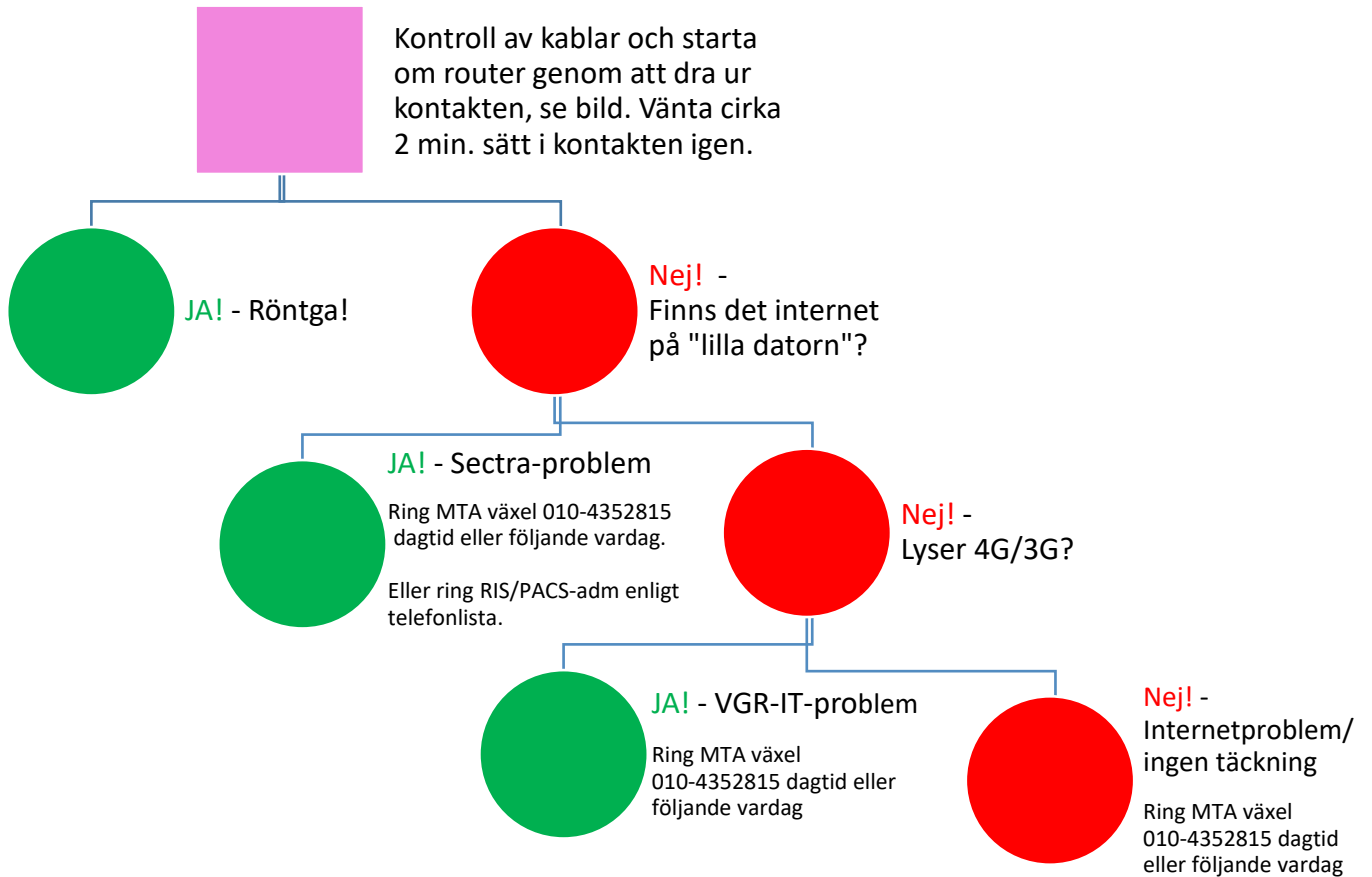

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-46

Version: 7.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11