

Förändring av Klamydia/gonokock PCR diagnostiken - proverna analyseras på Klinisk mikrobiologi Borås (SÄS) från den 8 december 2023. Gäller endast Asynja Visph kunder.

Laboratoriemeddelande

Distribution: Asynja Visph-kunder i primärvården och ungdomsmottagningar.


Diagnostiken av Chlamydia/Gonokock PCR i hela VGR har centraliserats till Klinisk mikrobiologi i Borås (SÄS). Det innebär **nya provtagningsrör** och lite längre svarstider. De gamla rören kommer inte längre att kunna analyseras, därför är det av största vikt att **rätt rör används till provtagning**. Analysen beställs i Asynja Visph labcenter med samma analyskoder som tidigare. Det är även elektroniska provsvar som tidigare. Proverna skickas som tidigare till NÄL, där de packas om och skickas till SÄS nästföljande vardag.
Frågor om provsvar sker till Klinisk mikrobiologi SÄS, telefonnummer 033-6161883.

Gonokock (Neisseria gonorrhoeae) som påvisats i analysen konfirmeras med en annan PCR på samma instrument och besvaras därefter ut till kund med uppmaning att gonorréodling skall tas innan antibiotikabehandling sätts in. **Odling tas i eSwab och utförs fortsatt på Klinisk mikrobiologi NÄL.** Beställning sker i labcenter som tidigare. Ange "gonokock påvisat på SÄS" i beställningen.

Provtagningsrören beställs på Marknadsplatsen

-Aptima multitest swab-kitet innehåller rör med transportvätska/lyseringsbuffert och en provtagningspinne för cervix, vaginal, urethra osv. Provtagningspinnen bryts av och lämnas kvar i röret efter provtagning. Rengöring av cervix före provtagning sker som tidigare med separat "Vaginal tork på pinne". Hållbarhet efter provtagning är 60 dagar i 2-30 °C

-Aptima urine specimen-kitet innehåller rör med transportvätska samt en transferpipett för uppsamling av urin. Vätskan är transportmedium/lyseringsbuffert och ska inte hällas ut. Det är viktigt att fylla på med urin så det hamnar mellan de två strecken som finns på röret, se [SÄS analyslista](#). Hållbarhet efter provtagning är 30 dagar i 2-30 °C.

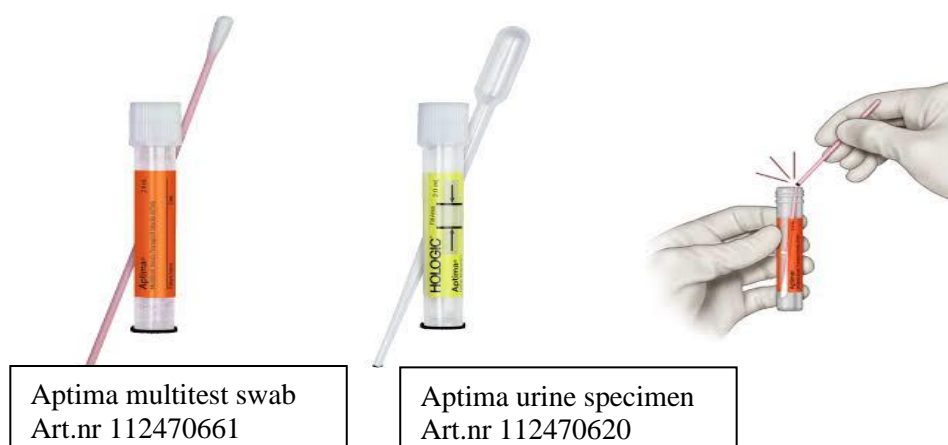

Aptima multitest swab
Art.nr 112470661

Aptima urine specimen
Art.nr 112470620

Frågor: Instruktör Darinka Bogicevic Andersson
Mejl: darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se
Telefonnummer: 010-435 30 34

Laboratoriemedicin, NU-sjukvården
Utfärdare: Annelie Malm
Godkänd av: Peter Brodin

Skapad: 2023-11-22