


## Bugg 1

**Vad händer-och när:** När användaren tittar på svaren i DICOM visaren visas svarsrapporterna default i fel tidsordning.

Det kan innebära att ett tilläggsvar inte visas default när rapporten öppnas

### Workaround:

1. Användaren ombedes att läsa CDA rapporten i stället för DICOM Svares SR. Den senaste rapporten visas alltid default i fältet som visar CDA rapporterna

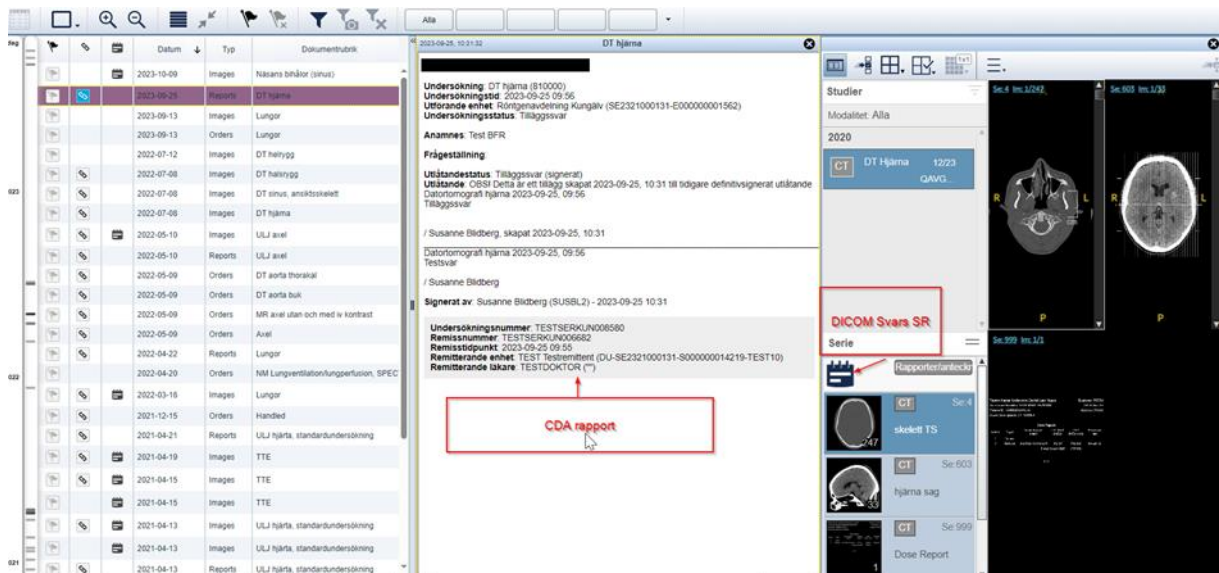

2. Alternativt om man är van att läsa DICOM Svares SR välja att öppna alla rapporterna en och en som finns tillgängliga i serieväljaren. Se bild nedan

**Studier**

**Serieväljare**

M Serieväljare

2 Alla  CT

|   | Datum        | Modalitet | Beskrivning   | Serie/bild | Arkivera  |
|---|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| ✓ | ▼ 2020-12-23 | CT        | DT Hjärna     | 3/281      | QAVGRSECT |
|   |              | SR        | Basic Text    |            |           |
|   |              | SR        | Basic Text SR |            |           |
|   |              | OT        | Exam Notes    |            |           |
| ✓ |              | CT        | skelett TS    | 247        |           |
| ✓ |              | CT        | hjärna sag    | 33         |           |
| ✓ |              | CT        | Dose Report   | 1          |           |

**DICOM Svans SR**

**Serie**

Rapporter/anteckn

Se: 4 Im: 1/247

Se: 603 Im: 1/33

Se: 999 Im: 1/1

CT Se: 4