


LATHUND – Dokumentera i arbetsflödet Hemodialys

Beskriver hur man dokumenterar i arbetsflödet Hemodialys

Informationen i komponenten **Ordination av hemodialys** adderas genom ordinationen **Ordination av hemodialys** som öppnar formuläret **Ordination av hemodialys** alternativt via komponenten.

1. Klicka på pilen nedåt i komponenten Ordination av hemodialys.

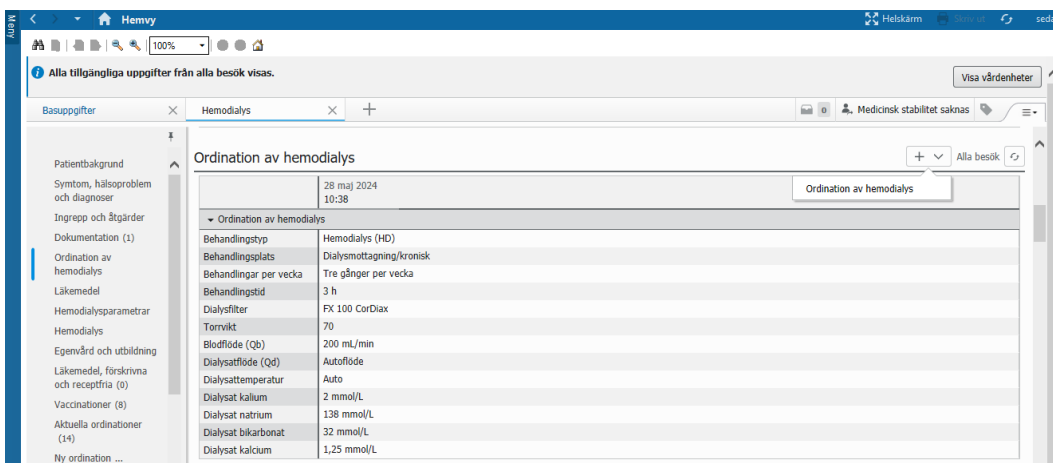

Figur 1. Ordination av hemodialys

2. Dokumentera i formuläret och signera.

Behandlingsmaskin	Behandlingstyp	Behandlingsplats	Behandlingsfall per vecka	Behandlingstid per session	Dialysfilter	Torrsvikt	Referenssvikt
<input type="radio"/> Fresenius 5005 CoDiAx <input type="radio"/> Fresenius 5008 CoDiAx <input type="radio"/> Physida S3 <input type="radio"/> KDSage <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> Hemodialys (HD) <input type="radio"/> Hemodialysation (HDF) <input type="radio"/> Hemofiltration (HF) <input type="radio"/> Hemodialys anlikasagialonadi <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> Dialysmottagning/kronisk <input type="radio"/> Dialysmottagning/akut <input type="radio"/> Värdavdelning <input type="radio"/> Intensivvårdavdelning <input type="radio"/> Hemibaserad <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> Tre gånger per vecka <input type="radio"/> Två gånger per vecka <input type="radio"/> Fyra gånger per vecka <input type="radio"/> En gång per vecka <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> 3 h <input type="radio"/> 3,5 h <input type="radio"/> 4 h <input type="radio"/> 4,5 h <input type="radio"/> 5 h <input type="radio"/> 5,5 h <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> FX 100 CoDiAx <input type="radio"/> FX 800 CoDiAx <input type="radio"/> FX 1000 CoDiAx <input type="radio"/> FX 100 <input type="radio"/> FX CoAL 100 <input type="radio"/> FX CoAL 800 <input type="radio"/> Annat		

Blodflöde (Qb)	Dialysatflöde (Qd)	Dialysattemperatur	Dialysat kalium	Dialysat natrium	Dialysat bikarbonat	Dialysat kalcium
<input type="radio"/> 150 mL/min <input type="radio"/> 175 mL/min <input checked="" type="radio"/> 200 mL/min <input type="radio"/> 250 mL/min <input type="radio"/> 300 mL/min <input type="radio"/> 350 mL/min <input type="radio"/> 400 mL/min <input type="radio"/> 450 mL/min <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> 200 mL/min <input type="radio"/> 300 mL/min <input type="radio"/> 400 mL/min <input type="radio"/> 500 mL/min <input type="radio"/> 600 mL/min <input type="radio"/> 700 mL/min <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> 35,00 <input type="radio"/> 35,50 <input type="radio"/> 36,00 <input type="radio"/> 36,50 <input type="radio"/> 37,00 <input type="radio"/> Annat	<input checked="" type="radio"/> 2 mmol/L <input type="radio"/> 3 mmol/L <input type="radio"/> 4 mmol/L <input type="radio"/> Annat	<input type="radio"/> 134 mmol/L <input type="radio"/> 135 mmol/L <input type="radio"/> 137 mmol/L <input checked="" type="radio"/> 138 mmol/L <input type="radio"/> 139 mmol/L <input type="radio"/> 140 mmol/L <input type="radio"/> 141 mmol/L	<input checked="" type="radio"/> 32 mmol/L <input type="radio"/> 33 mmol/L <input type="radio"/> 34 mmol/L <input type="radio"/> 35 mmol/L <input type="radio"/> 36 mmol/L <input type="radio"/> 37 mmol/L <input type="radio"/> 38 mmol/L <input type="radio"/> 39 mmol/L	<input checked="" type="radio"/> 1,25 mmol/L <input type="radio"/> 1,50 mmol/L <input type="radio"/> 1,75 mmol/L <input type="radio"/> Annat


Total ultrafiltrationsvolym	Maximal ultrafiltrationshastighet	HDF Ersättningsvätska	Särskilda instruktioner
		<input type="radio"/> HDF Ersättningsvätska, post <input type="radio"/> HDF Ersättningsvätska, pre <input type="radio"/> Annat	

Dialysaccess	Access, lokalisat	Nålstorlek	Nållängd	Typ av nål	Stickteknik	Kateterlös
<input type="radio"/> Arteriovenös fistel <input type="radio"/> Arteriovenös graft <input type="radio"/> Dialyskateter tunnleled <input type="radio"/> Dialyskateter icke tunnleled <input type="radio"/> Annat	<input type="radio"/> Underarm, höger <input type="radio"/> Underarm, vänster <input type="radio"/> Översarm, höger <input type="radio"/> Översarm, vänster <input type="radio"/> Jugulär interna, höger <input type="radio"/> Jugulär interna, vänster	<input type="radio"/> 14 gauge <input type="radio"/> 15 gauge <input type="radio"/> 16 gauge <input type="radio"/> 17 gauge <input type="radio"/> Annat	<input type="radio"/> 14 mm <input type="radio"/> 15 mm <input type="radio"/> 20 mm <input type="radio"/> 25 mm	<input type="radio"/> Vass <input type="radio"/> Tubbig	<input type="radio"/> Nytt instick varje gång <input type="radio"/> Buttonhode <input type="radio"/> Floppshode <input type="radio"/> Areapuncture <input type="radio"/> Annat	<input type="radio"/> Citat <input type="radio"/> Altoplast <input type="radio"/> Teurolock Urokinas 25000 <input type="radio"/> Teurolock Hep 500 <input type="radio"/> Annat

Figur 2. Formulär för dokumentation


I komponenten **Hemodialysparametrar** visas information dokumenterad i **Interaktiv vy** under bandet Hemodialys och sektionen **Hemodialys, Behandlingsinställningar** och **Hemodialys, övervakning**.

3. Klicka på pilen nedåt i komponenten **Hemodialysparametrar**.



Figur 3. Komponent Hemodialysparametrar


4. Dokumentera i exempelvis **Behandlingsinställningar** och signera.

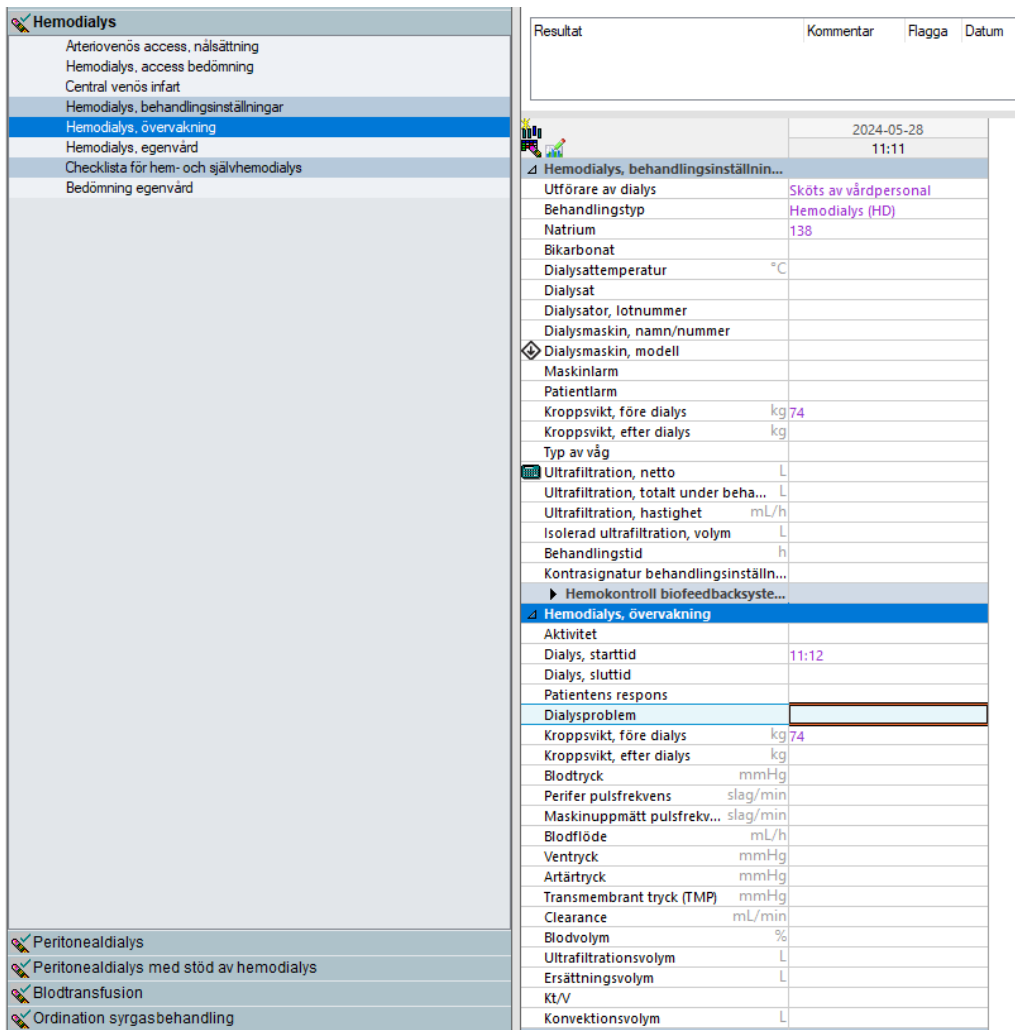

Figur 4. Dokumentation av mätvärden


I komponenten **Egenvård och utbildning** visas information dokumenterad i Interaktiv vy i bandet **Hemodialys** och sektionerna **Hemodialys, egenvård, Checklista för hem- och självhemodialys** och **Bedömning egenvård**.

5. Klicka på pilen nedåt i komponenten **Egenvård och utbildning**.

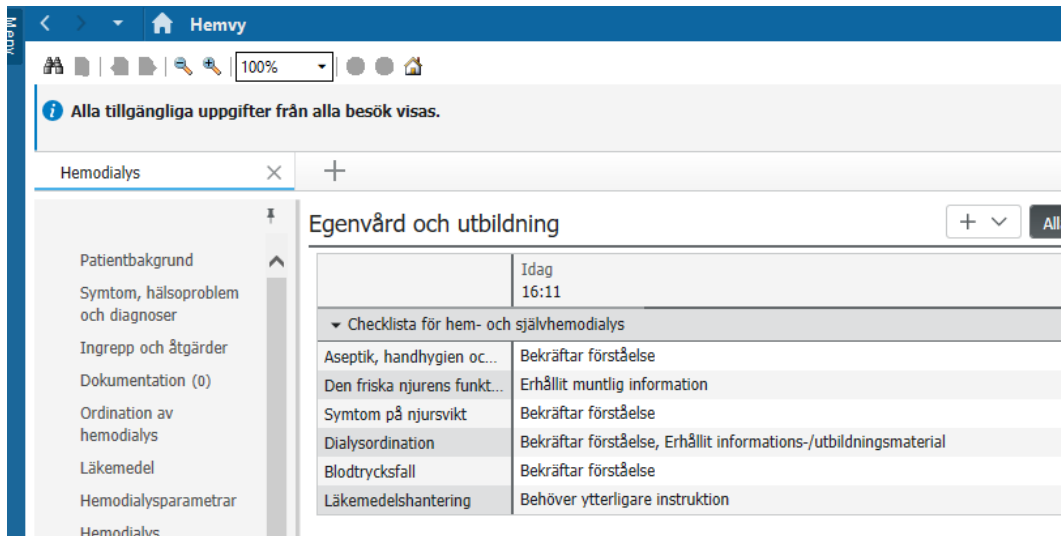

Figur 5. Komponent Egenvård och utbildning

6. Dokumentera om egenvård och/eller i checklistan för hem och självdialys.

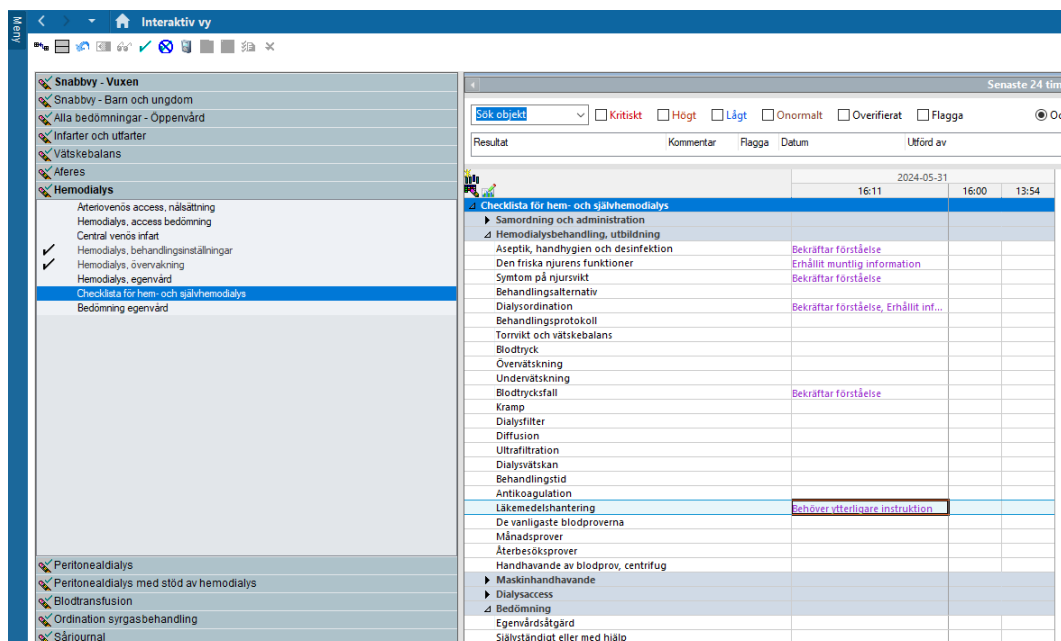


Figur 6. Dokumentation av mätvärden

Längst ner i arbetsflödeskomponentsmenyn för Hemodialys under **Skapa anteckning** finns anteckningar specifikt för hemodialys. Finns det dokumentation om Access, Egenvård och Infarter och

utfarter från interaktiv vy, eller text från komponenterna Aktuellt och Bedömning och planering följer dokumentationen med in under dessa rubriker i anteckningen.

7. Välj aktuell Hemodialysanteckning
8. Se över dokumentationen, komplettera vid behov. Signera när anteckningen är klar.

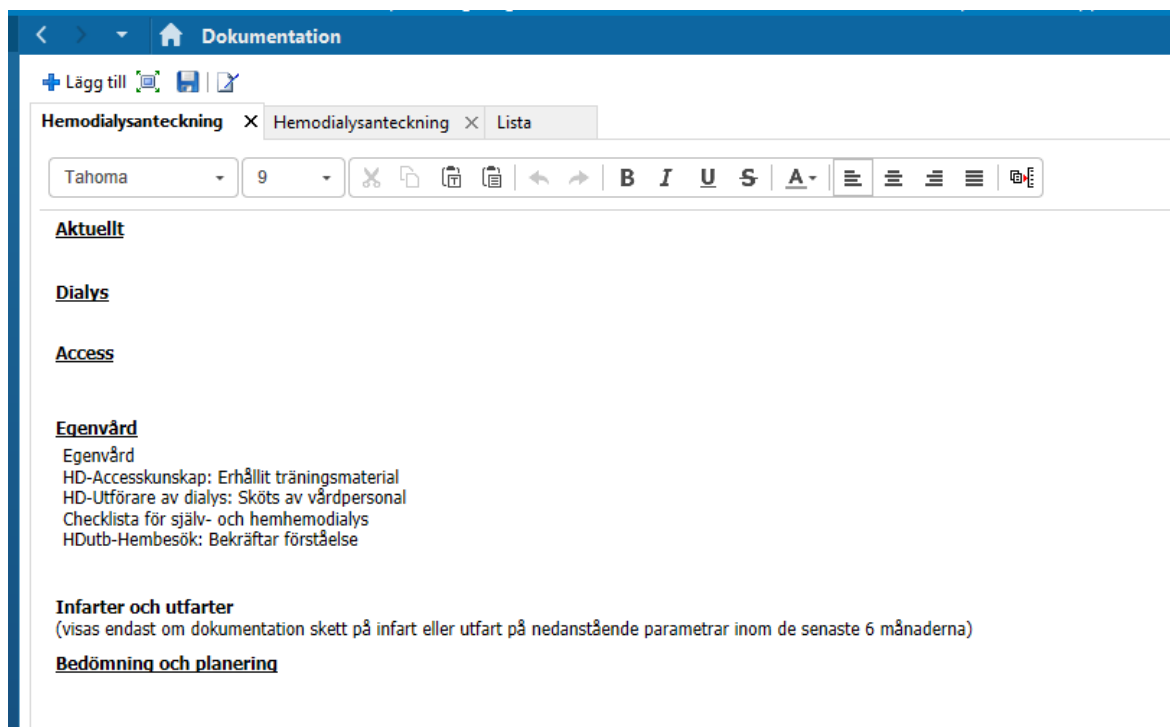

Figur 7. Anteckning