



Förberedelse av operationsbordet:



Detta är en grundinställning och kan behöva justeras efter patientens storlek och längd

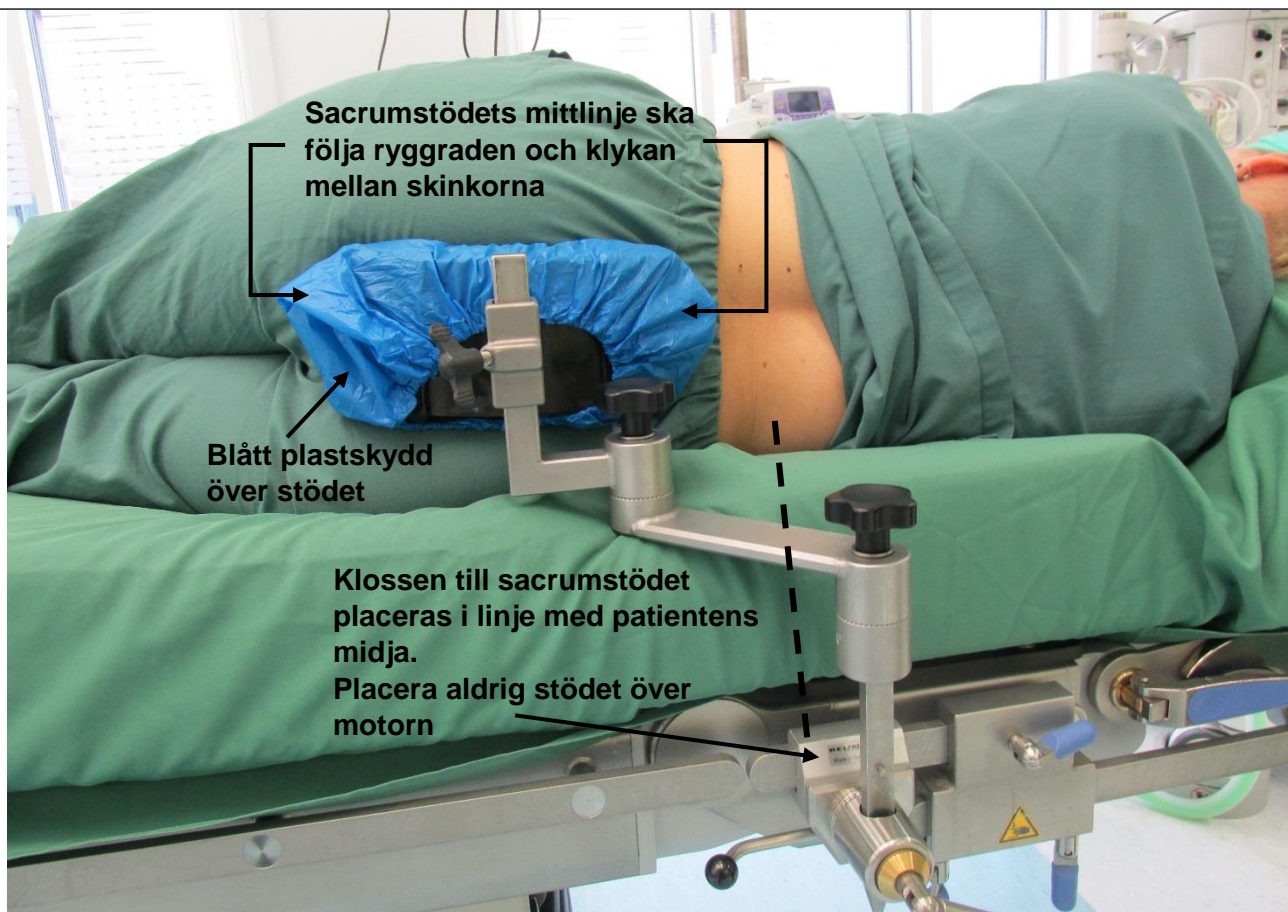

Detta är en grundinställning och kan behöva justeras efter patientens storlek och längd

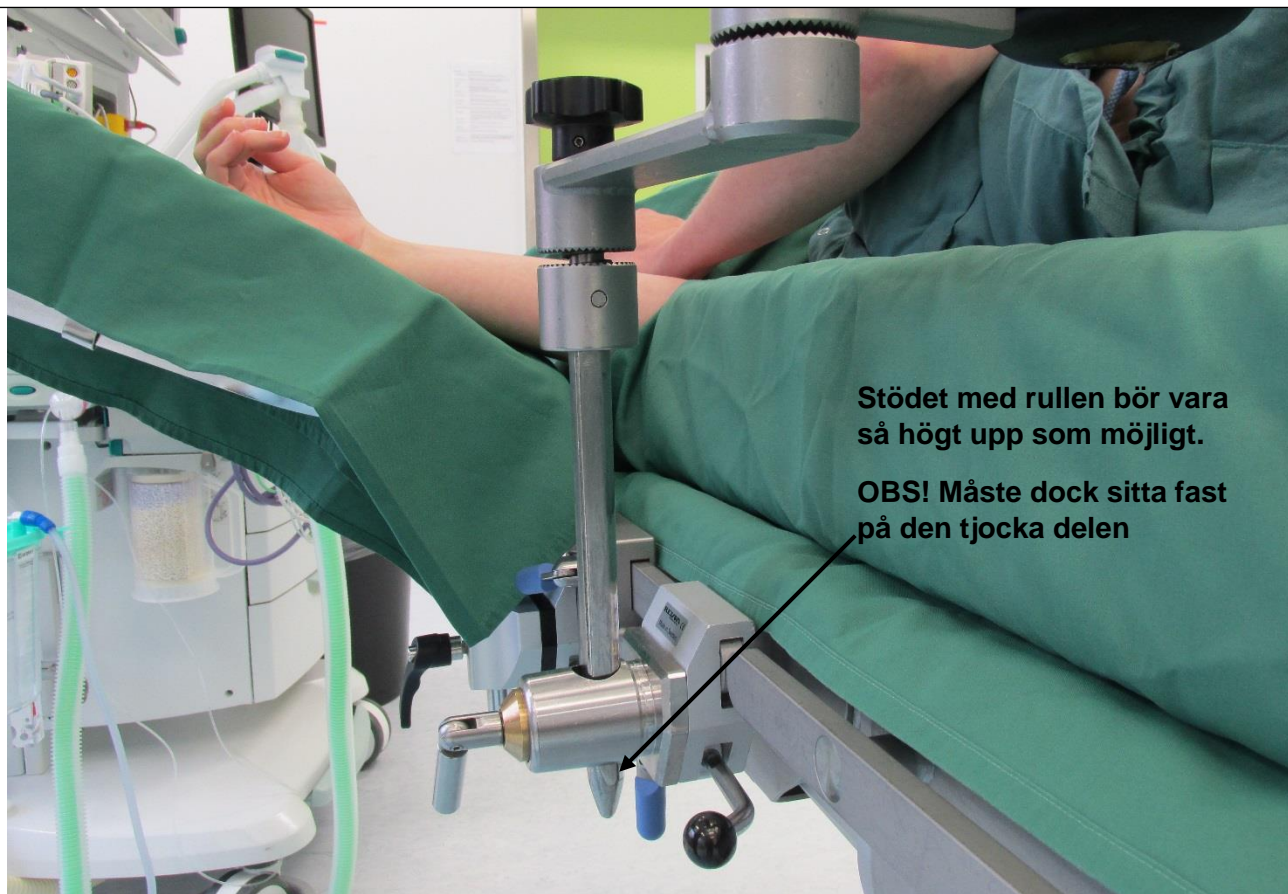

Detta är en grundinställning och kan behöva justeras efter patientens storlek och längd

**Stödet trycks mot höftbenskammen.
Polstra med geldyna samt blå
plastsydd (ej med på bild)**


**Kontrollera färgen på benet så att inte
a.femoralis kläms åt**

Se till att benet kan föras fram 90 grader

**Ibland kan denna fästansordning flyttas ett steg för
att förbättra patientens fixation**

**Stödet placeras upp mot klossen som är till dubbla skenor
(mindre i vägen för assistenten). Dock inte över motorn**



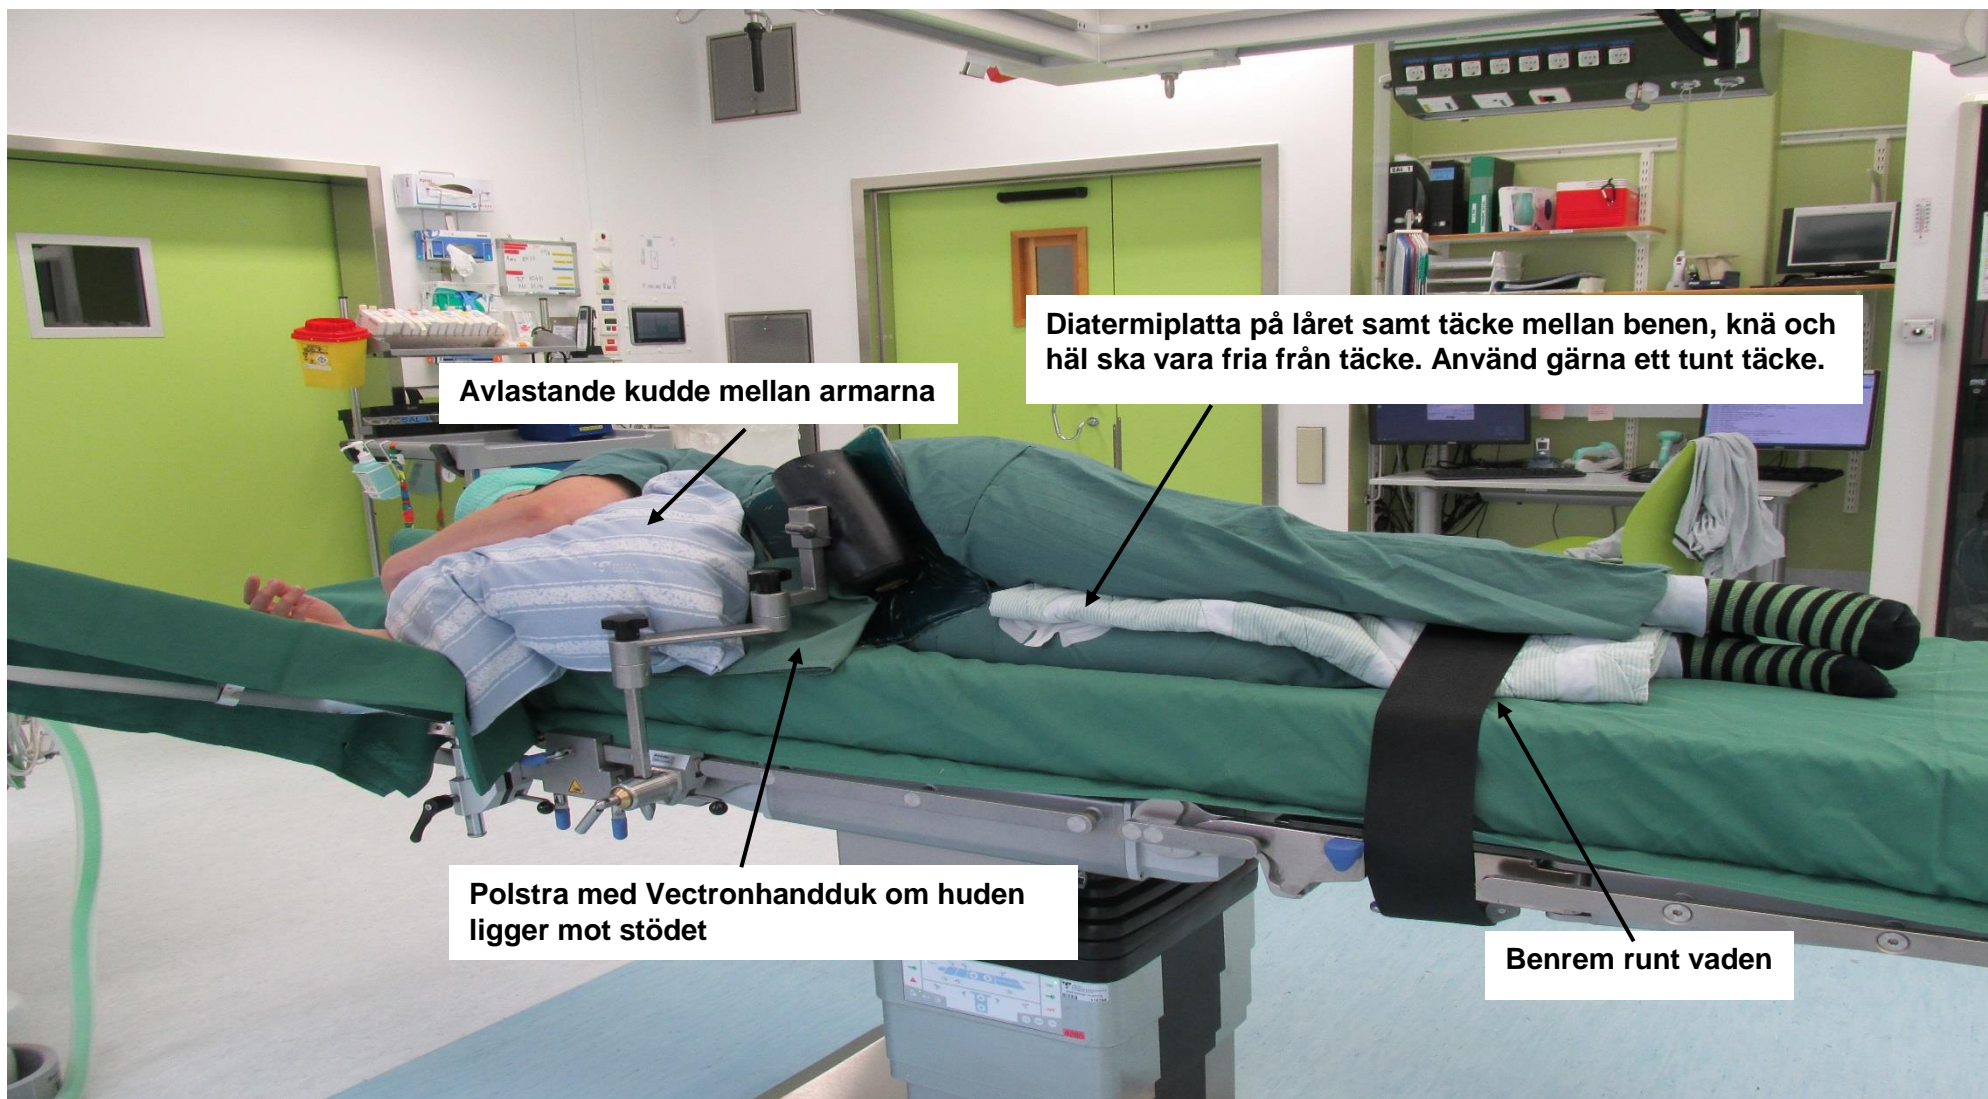

Avlastande kudde mellan armarna

Diatermiplatta på låret samt täcke mellan benen, knä och häl ska vara fria från täcke. Använd gärna ett tunt täcke.

Polstra med Vectronhandduk om huden ligger mot stödet

Benrem runt vaden



Patienten ska ligga rak på bordet med axelpartiet, höften och benet i en rak linje.

Vid svårighet be operatören om hjälp vid upplägget.

Narkosbåge placeras så högt upp mot huvudet som det är möjligt (ej med på bild)