


Rätt mätare till rätt patient

En vägledning i ditt val av glukosmätare i VGR

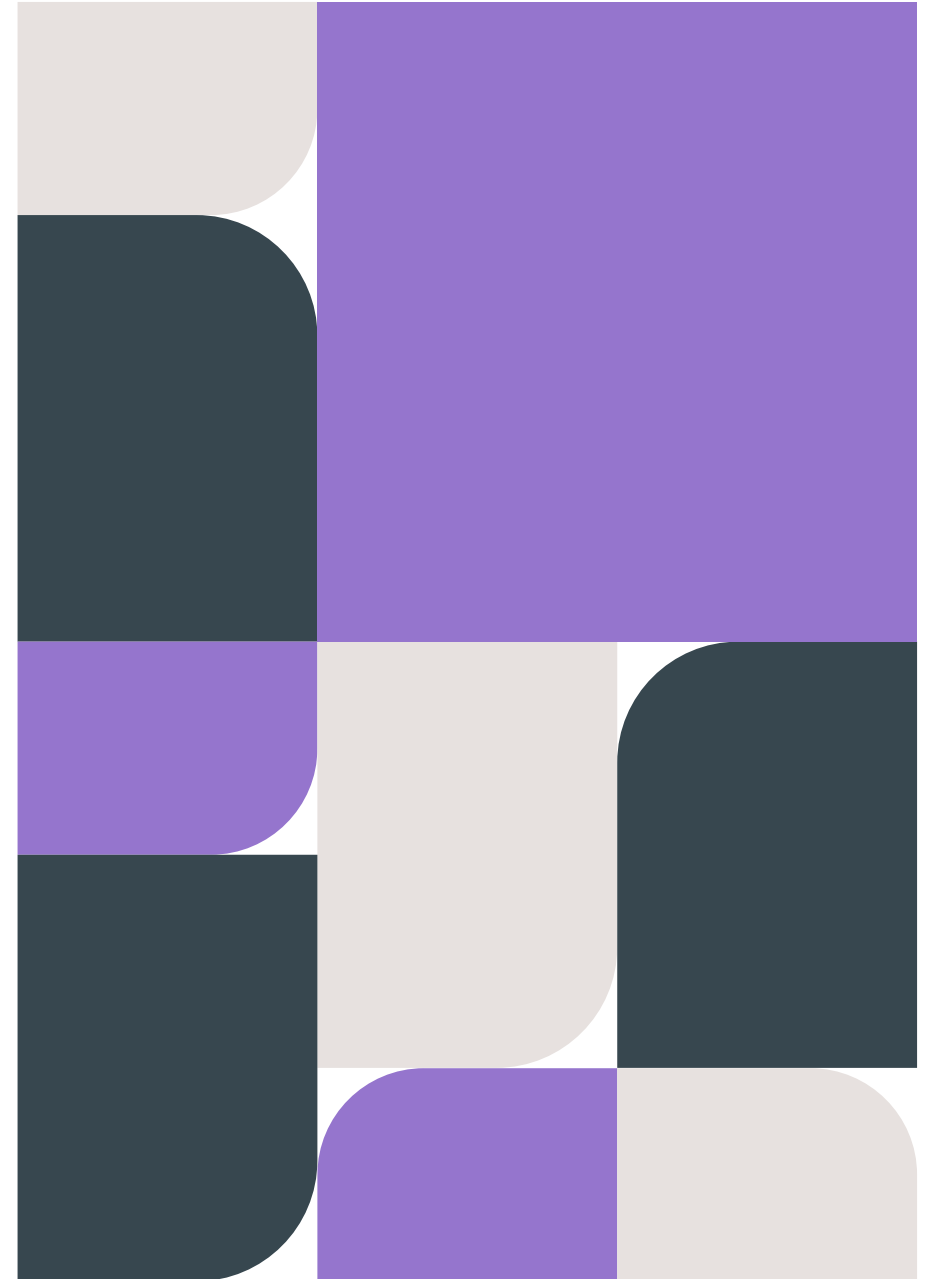

ISO standard 15197:2015

Blodglukosvärde 5,6 mmol/L eller lägre				Blodglukosvärde 5,6 mmol/L eller högre		
Mätare	Värden inom +/- 0,83 mmol/L	Värden inom +/- 0,56 mmol/L	Värden inom +/- 0,28 mmol/L	Värden inom +/- 15%	Värden inom +/- 10%	Pris/ styck
Accu-Check Mobile	100%	99,5%	89,8%	100%	99,3%	2,85 kronor
Accu-Check Instant	100%	100%	94,4%	100%	99,3%	1,24 kronor
Wellion Calla Dialog	97,6%	79,5%	51,4%	99,2%	93,8%	0 kronor
Wellion NEWTON	100%	98,4%	75,7%	100%	99,0%	0 kronor
Contour Next	100%	100%	94%	100%	100%	1,10 kronor
Contour Care	100%	99,4%	80,5%	100%	99,1%	1,10 kronor
Glucomen Areo GK	100%	99%	73,7%	99,8%	97,8%	1,30 kronor
GALILEO Glu/Ket	100%	96,8%	73,1%	100%	96,9%	0 kronor