OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-27
Giltig till: 2028-10-27

55GD Nedre buken inkl. lilla bäckenet

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M55900** **MR nedre buken inkl lilla bäckenet utan och med iv kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Sjukdomstillstånd i lila bäckenet, tumör, abcess och fistlar
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka Venflon Krea: Se länk
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Bäckenskovel


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Spole	Anterior
Kontrastmedel	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Clariscan 0,2 ml x kroppsvikt
Läkemedel	
Efterbearbetning	
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	**Snitt-plan**	**Snitt-tjocklek**	**Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)**
Survey			
T2	SAG	4mm	Från sida till sida
T2	COR	4mm	Främre bukväggen bakom sacrum
T2	TRA	4mm	Från promontorium till nedom symfysen
DWI	TRA	5mm	b-värde: 3T: 0, 120, 1000 s/mm2 1.5T: 50, 800 s/mm2 ADC-karta
T1 Dixon IOW	TRA	4mm	Som ovan
Kontrast			
T1 Dixon	TRA	4mm	Direkt efter injektion
T1 Dixon	SAG	4mm	Efter föregående serie
Ti Dixon	COR	4mm	Efter föregående serie

SAG

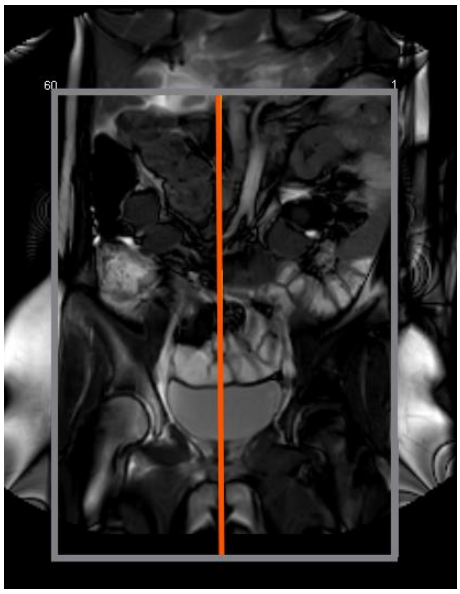

TRA



COR





Hängningsprotokoll

1 Ny undersökning

T2 sag	T2 tra	T2 cor	T1 Dixon tra	T1 GD Dixon tra
DWI tra	DWI adc		T1 GD Dixon cor	T1 GD Dixon sag

1 Ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T2 sag	T2 tra	T2 cor			
DWI tra	DWI adc	T1 Dixon tra			
T1 Dixon tra	T1 GD Dixon cor	T1 GD Dixon sag			

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Plan

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-54

Version: 1.0

Giltig från: 2026-10-27

Giltig till: 2028-10-27