

Gäller för: Sjukhusen i väster

Giltig från: 2026-04-16

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-04-16

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

## 24B Ländrygg utan och med kontrast

### Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.



<b>Us kod/Us namn</b>	<b>M24900</b> <b>MR Ländrygg utan och med iv kontrast</b>
<b>Fältstyrka</b>	1.5 och 3 Tesla
<b>Indikation</b>	
<b>Förberedelser</b>	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka <b>Venflon:</b> Rel GFR på pat över 70år och riskpatienter. <b>Krea&lt;3 mån, fråga dr GFR&lt;30</b>
<b>Patientposition</b>	Pat ligger på rygg med fötterna först. Kudde under knän om så önskas.
<b>Centrering</b>	Crista
<b>Spole</b>	Inbyggd ryggs pole i bordet

<b>Kontrastmedel</b>	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Claiscan 0,2 ml x kroppsvikt
<b>Läkemedel</b>	
<b>Efterbearbetning</b>	MPR 2mm tra på aktuell nivå
<b>Dokumentation</b>	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
<b>MR-säkerhet</b>	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

### Sekvenser/kriterier

<b>Sekvens</b>	<b>Snitt-plan</b>	<b>Snitt-tjocklek</b>	<b>Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)</b>
<b>Survey</b>			
<b>Stir</b>	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på cor-bilden, aktuellt område
<b>T1 Dixon</b>	SAG	4mm	Som ovan
<b>Kontrast</b>			
<b>3D spine VIEW</b>	SAG	1,4mm	Som ovan
<b>T1 Dixon</b>	SAG	4mm	Som ovan
<b>T1 Dixon</b>	TRA	3mm	Över aktuellt område

## SAG

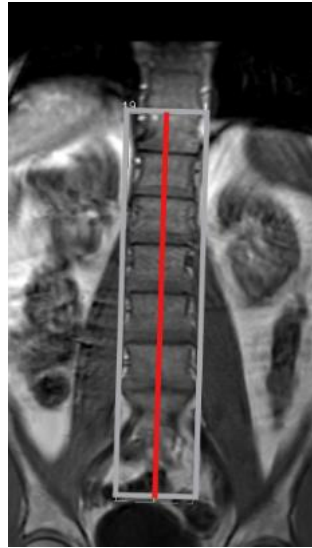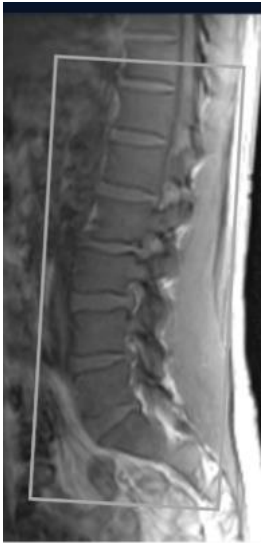

## TRA



## MPR

1. Markera bilden du skall göra MPR på (3D spine VIEW)
2. Högerklicka, Slab
3. Present: -rullgardin, välj Mpr tra

## Hängningsprotokoll

### 1 ny undersökning

Stir Sag	T1 dixon sag	T1 GD sag	T1 GD sag
3D Sag	T2 tra		

### 1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Stir Sag	3D Sag	T2 tra
T1 dixon sag	T1 G dixon sag	T1 G dixon tra

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sjukhusen i väster

**Innehållsansvar:** Yvonne Sundling, (yvosu3),  
Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Helena Markström, (helab5), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-48892422-64

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-04-16

**Giltig till:** 2028-04-16