OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-21
Giltig till: 2028-10-21

24B Ländrygg utan och med kontrast

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M24900** **MR Ländrygg utan och med iv kontrast**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Tumör, abcess
Förberedelser	Id och frågeformulär Pat byter om till vit skjorta Hörselskydd och alarmklocka Venflon Krea: se länk
Patientposition	Pat ligger på rygg med fötterna först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Crista
Spole	Inbyggd ryggspole i bordet


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN


Kontrastmedel	Gadovist 0,1 ml x kroppsvikt el Claiscan 0,2 ml x kroppsvikt
Läkemedel	
Efterbearbetning	MPR 2mm tra på aktuell nivå
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)
Survey			
Stir	SAG	4mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor-bilden. Aktuellt område el Th12-S2
T1 Dixon	SAG	4mm	Som ovan
Kontrast			
3D spine VIEW	SAG	1,4mm	Som ovan
T1 Dixon	SAG	4mm	Som ovan
T1 Dixon	TRA	3mm	Över aktuellt område

SAG

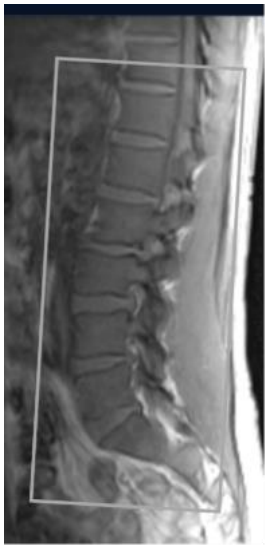

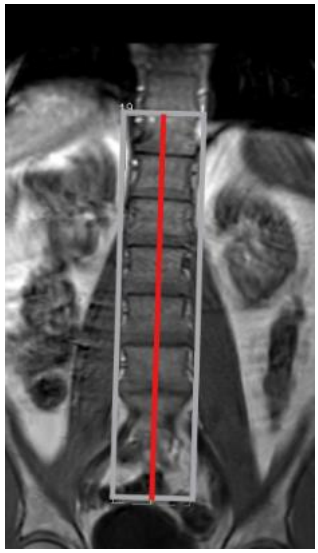

TRA



MPR

1. Markera bilden du skall göra MPR på (3D spine VIEW)
2. Högerklicka, Slab
3. Present: -rullgardin, välj Mpr tra

Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

Stir Sag	T1 dixon sag	T1 GD sag	T1 GD sag
3D Sag	T2 tra		

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

Stir Sag	3D Sag	T2 tra
T1 dixon sag	T1 G dixon sag	T1 G dixon tra

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-64

Version: 2.0

Giltig från: 2026-10-21

Giltig till: 2028-10-21